



Neatbilstoši bezkontakta infrasarkanie termometri Latvijā tirgū

Publicēts: 21.12.2020.

[Brīdinājumi](#)


[Informācija](#)

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz tirgū pieejamiem prasībām neatbilstošiem bezkontakta infrasarkanajiem termometriem. Neatbilstošajiem infrasarkanajiem termometriem nav norādīts ražotājs vai tiem nav veikta atbilstības novērtēšanas procedūra, līdz ar to ierīce nav marķēta ar atbilstošu CE atbilstības marķējumu t.i. pie CE marķējuma nav norādīts paziņotās institūcijas identifikācijas kods jeb četrциparu kombinācija.

Infrasarkanajam termometram ir jābūt marķētiem ar CE atbilstības marķējumu un pie tā ir jābūt norādītam četrциparu identifikācijas kodam. Uz tā tirdzniecības iepakojuma un ierīces ir jābūt norādītam ražotājam, sērijas (SN) vai partijas (LOT) numuram, nosaukumam un gadījumā, ja ražotājs atrodas ārpus Eiropas Savienības, tad arī ražotāja Eiropas Savienības pārstāvim.

Iesakām pievērst uzmanību attēlos redzamajām neatbilstībām un pirms bezkontakta infrasarkanā termometra iegādes, lūdzam pārliecināties par termometra atbilstību prasībām.

Ierīce Nr. 1.

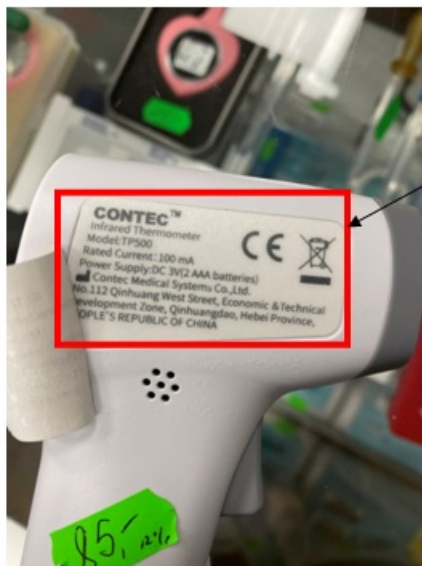

Infrasarkanais termometrs ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, bet pie CE marķējuma nav norādīts četrциparu identifikācijas kods un nav norādīts ražotāja ES pārstāvis, līdz ar ko medicīniskā ierīce nav atbilstoša prasībām.

Ierīce Nr.2.



Infrasarkanais termometrs TF-600 nav marķēts ar CE atbilstības marķējumu, kā arī nav norādīts ražotājs.



ADVANTAGES

- Multiple Functions: 0-100°C/32-212°F wide range, not only for body temperature, but also for temperature of room, object, water, food, milk, wine etc.
- Temperature Indication (color alarm): green backlight for normal body temperature
- 3.3mm measuring range, safe and clean
- Data and operation record is stored with 255 (255) positions
- °C and °F switches
- 30 memories
- Alarm point for babies
- Settings for adjustable for different kinds of people and working conditions
- Automatic shut off: 30 seconds without operation
- buzzer shut off (optional)

SPECIFICATIONS


Model	TF-600
Measuring Range	0-42.0°C / 0.0-108.0°F (Object mode) 0-100°C (0-212°F)
Measuring Accuracy	±0.2°C / ±0.4°F
Measuring time	0.5 second
Measuring distance	1-10CM
Measures	30
Three color backlight	Green backlight (Normal) 0-42.0°C / 0.0-108.0°F Yellow backlight (High heat) 42.0-44.0°C (108-110°F) Red backlight (High fever) 44.0-46.0°C (110-115°F) Note: Temperature applied to only for body, water, deep blue backlight for surface water.
Resolution	0.1°C / 0.1°F
Battery	3x 3V (7AAA)
Auto shut-off	30 seconds
Top product size	Length: 150 mm, width: 45 mm, height: 60 mm
Product weight	145g (without battery)
Expiration date	3 years
Operating environment	0-40°C / 41-104°F, Humidity: 0-90%

Ierīce Nr.3.

Bezkontakta infrasarkanā termometra IR-FM tirdzniecības iepakojums



Bezkontakta infrasarkanā termometra IR-FM etiķete

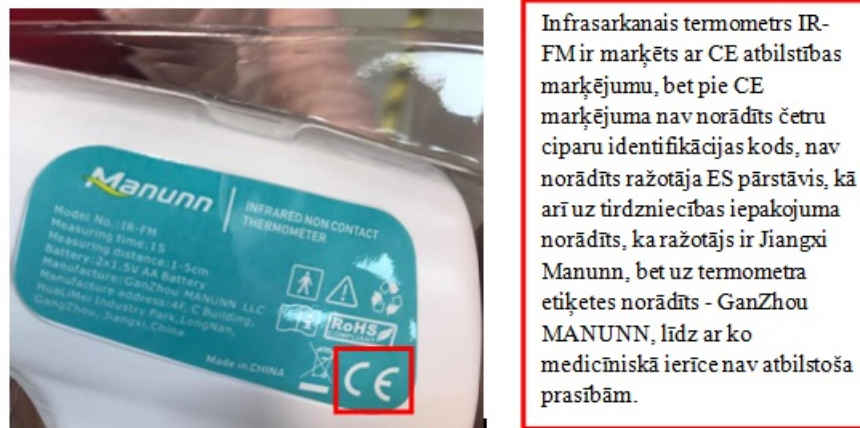

Infrasarkanais termometrs IR-FM ir marķēts ar CE atbilstības marķējumu, bet pie CE marķējuma nav norādīts četru ciparu identifikācijas kods, nav norādīts ražotāja ES pārstāvis, kā arī uz tirdzniecības iepakojuma norādīts, ka ražotājs ir Jiangxi Manunn, bet uz termometra etiķetes norādīts - Ganzhou MANUNN, līdz ar ko medicīniskā ierīce nav atbilstoša prasībām.

<https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/neatbilstosi-bezkontakta-infrasarkanie-termometri-latvijas-tirgu>